


<b>RICHTLINIE</b> Kontrastmittel	<b>Salzburger Landeskliniken</b> <b>Universitätsinstitut für Radiologie der PMU</b>	
Titel: <b>KM-Gabe und Nierenfunktionsparameter</b>		Version: 07
Gültig für: Alle MA		Gültig ab: 01.11.2019

Diese Richtlinie regelt die Verwendung jodhaltiger Kontrastmittel in Abhängigkeit der Nierenfunktionsparameter bei Elektivuntersuchungen. Notfalluntersuchungen sind davon nicht betroffen. Grundlage sind die aktuell gültigen ESUR Richtlinien.

Zeitpunkt der Bestimmung der Nierenfunktion:

- **Aktuelles Labor** bei akuter Erkrankung, akuter Verschlechterung einer chronischen Erkrankung oder bei hospitalisierten Patienten
- **innerhalb von 3 Monaten** vor KM-Applikation bei allen anderen Patienten

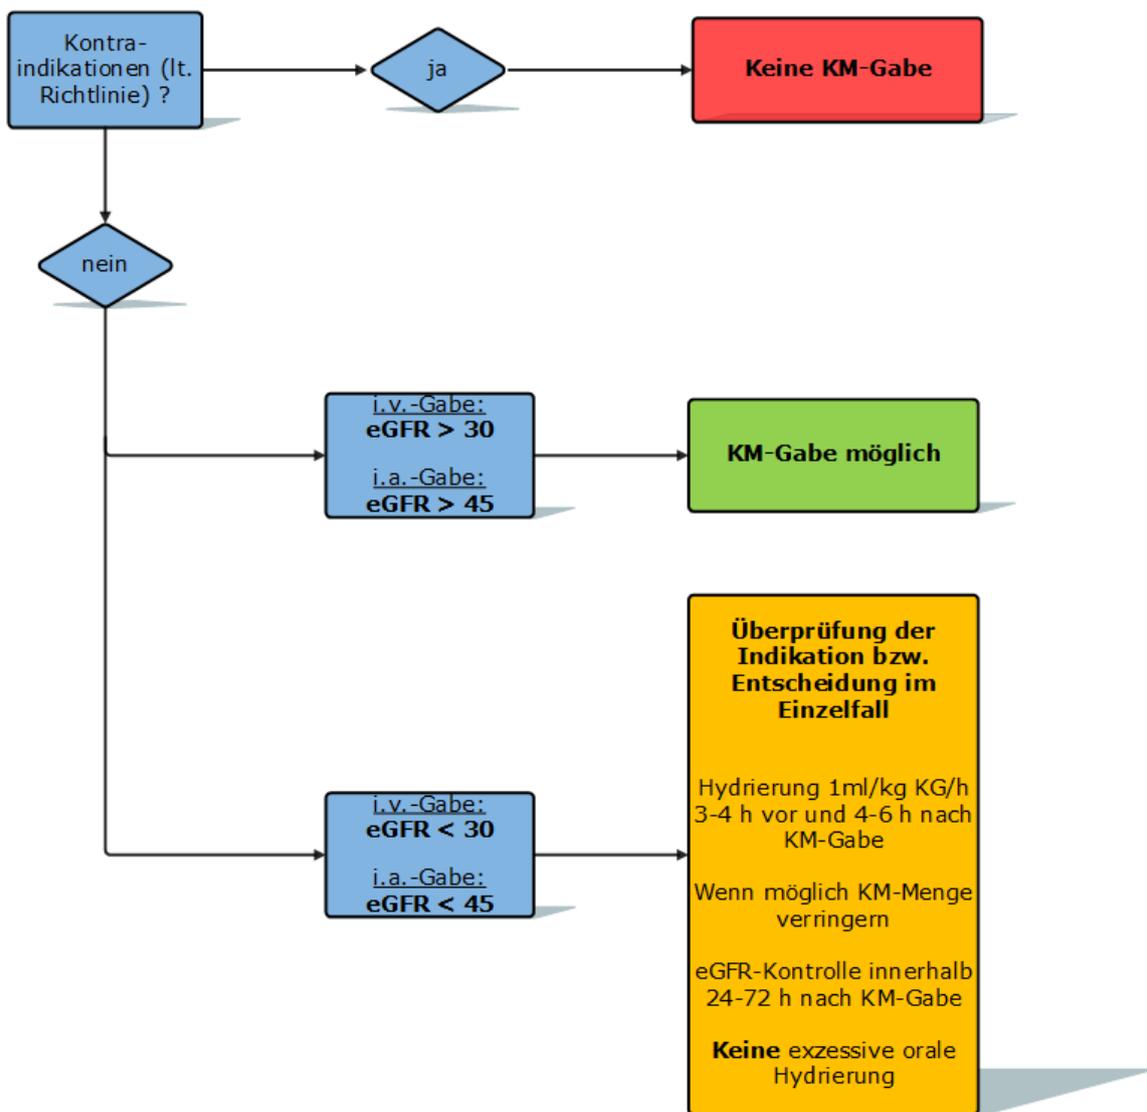

Erstellt von:	Lauschmann	Datum:	22.10.2019	Unterschrift: (nur am Original)
Geprüft von:	Heschl	Datum:	23.10.2019	Unterschrift: (nur am Original)
Freigegeben von:	Hergan	Datum:	24.10.2019	Unterschrift: (nur am Original)